

## 容器変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、精度向上のため、下記容器につきまして、容器を変更させていただくこととなりました。

先生方には大変お手数をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ■ 変更実施日

2020年8月中旬より順次変更

#### ■ 対象容器

A-① 一般容器分離剤入(全血用)

B-① 血糖容器(フッ化 Na 入)

C-① 血球容器(EDTA 2K 入)

\* 別紙ご参照ください。

#### ■ 変更内容

キャップの密閉性の向上のため、製造メーカーの変更を実施いたします。

変更により、B 容器のキャップの色が現行の黄色よりグレー色に変更になります。


A 容器と C 容器についてキャップの色の変更はございません。

\* 現在お使いの容器は引き続き、ご使用いただけますが、次回ご依頼分より新容器となります。


以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL:075-631-6230

A-① 一般容器分離剤入(全血用)

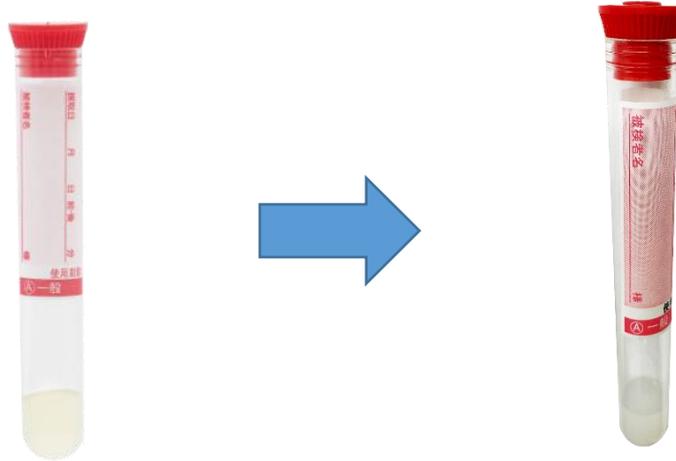

B-① 血糖容器(フッ化 Na 入)

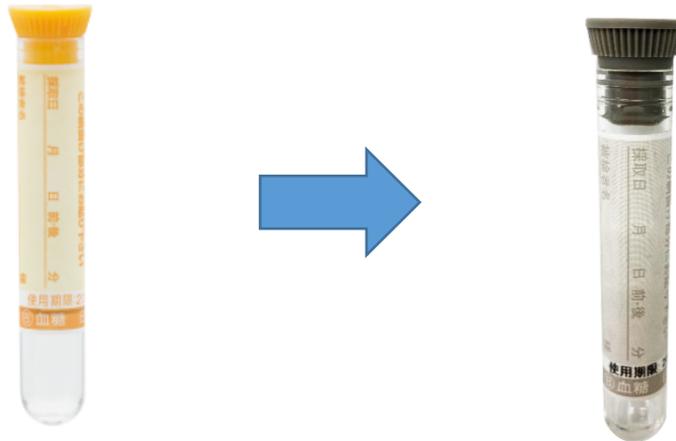

C-① 血球容器(EDTA 2K 入)

