

NR33019 中止  
2021年9月

## 検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

このたび試薬製造メーカーによる試薬販売中止の為、下記の検査項目につきまして検査の受託を中止することとなりましたので謹んでご案内申し上げます。

ご利用の先生方には大変ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### ■検査受託中止項目及び最終受付日

2021年12月28日(火) ご依頼分をもって受託中止

	中止項目	代替項目	掲載ページ
項目コード	1682	1681	39 41 43
項目名称	特異 IgE シングルアレルゲン ハウスダスト2	特異 IgE シングルアレルゲン ハウスダスト1*	
検査方法	[CLEIA](アラスタット)	[CLEIA](アラスタット)	

※1681：ハウスダスト1と1682：ハウスダスト2の関連データは別紙参照。

以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL：075-631-6230

【ハウスダスト1とハウスダスト2の相関データ】

クラス相関 (ハウスダスト1とハウスダスト2)

ハウスダスト2	6							2
5							10	
4					11	4		
3				20				
2			7	3				
1	3	8	2					
0	103	4						
	0	1	2	3	4	5	6	
	ハウスダスト1							


陽性一致率 = 97%

陰性一致率 = 97%

判定一致率 = 95%

N = 177

相関データ (ハウスダスト1とハウスダスト2)

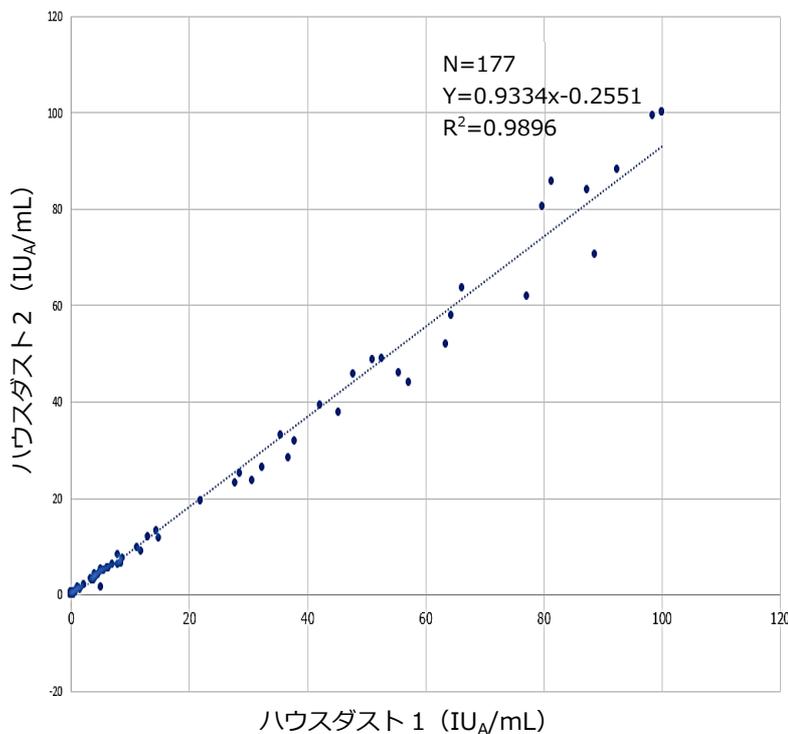

(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社検討データ)