

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、試薬販売中止に伴い、現法と同等の性能を有する機器・試薬に変更させていただきたく、ご案内申し上げます。尚、変更に伴い、測定実施場所を変更させていただきます。

ご利用の先生方には急な変更となりご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 変更内容及び実施日

2023年1月31日(火) ご依頼分より

項目コード	検査項目	検査案内掲載ページ	変更内容	新	現
3392	ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド (HANP)	P24	測定実施場所 (記号)	エスアールエル セントラルラボラトリー ((12&1)	エスアールエル 八王子ラボラトリー ((12&ウ)
			報告範囲 (pg/mL)	5.0未満、5.0~2990、3000以上	5.0未満、5.0~1990、2000以上

※ 検査方法、基準値、報告単位等の変更はございません。

以上


検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL:075-631-6230

● ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド (HANP)


測定試薬販売中止に伴い、試薬を変更させていただきます。

▼現法と新法の比較

①全体

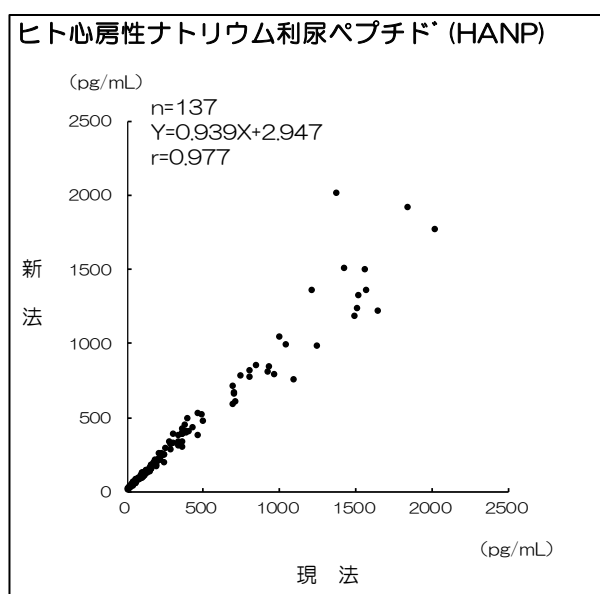

②低濃度域 (200pg/mL以下)

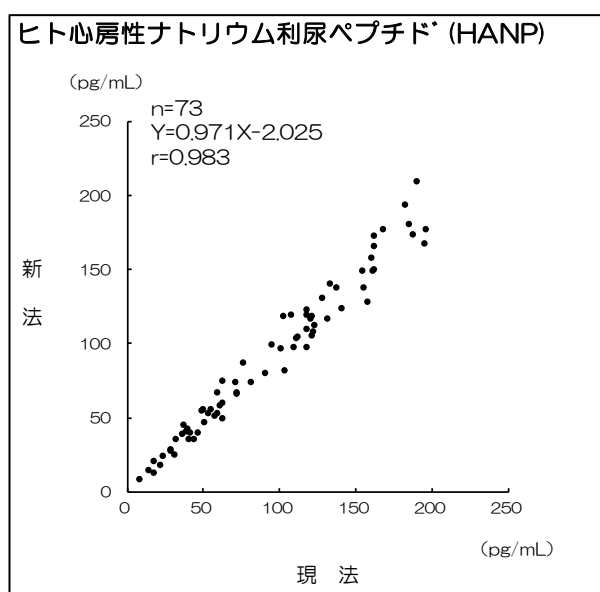

●検査方法参考文献

浜 典男, 他:基礎と臨床 25(13):455~462, 1991.