



長25010変更

2026年1月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り
厚くお礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、測定試薬の変更に伴い検査内容の変更をさせ
ていただくこととなりましたので謹んでご案内申し上げます。

ご利用の先生方には何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 変更内容および実施日

【実施日】2026 年 4 月 1 日(水)ご依頼分より

項目 コード	検査項目	変更内容	新	現	検査案内 掲載頁
P083 4	HCV抗体 (第3世代)	報告範囲	0.1~299.0、 300.0以上	0.1~84.0	P52
		検診の高中低 力価範囲	低力価:1.0以上 10.0未満 中力価:10.0以上 200.0未満 高力価:200.0以上	低力価:1.0以上 5.0未満 中力価:5.0以上 50.0未満 高力価:50.0以上	


本検査におきまして、試薬を変更させていただきます。

基準値に変更はございません。



■ 現法と新法の比較

○ 相関性

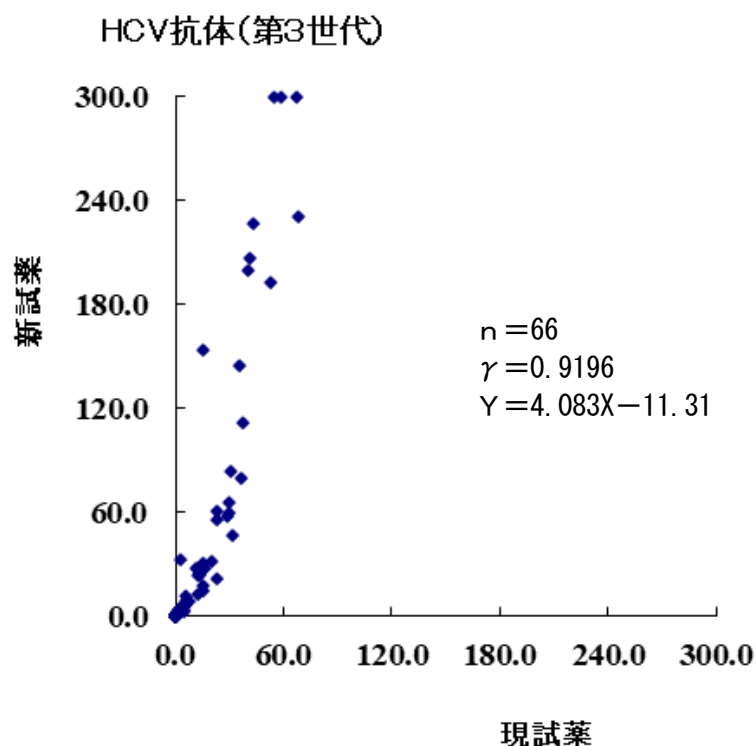

○ 判定一致表

判定		現試薬	
		陰性	陽性
新試薬	陰性	21	0
	陽性	0	45

判定一致率100%(N=66)



○力価別一致表

判定			現試薬			
			陰性	低力価	中力価	高力価
			1.0未満	1.0以上 5.0未満	5.0以上 50.0未満	50.0以上
新試薬	陰性	1.0未満	21	0	0	0
	低力価	1.0以上 10.0未満	0	9	3	0
	中力価	10.0以上 200.0未満	0	1	25	1
	高力価	200.0以上	0	0	2	4

力価別一致率89.4% (59例/66例)