



西26018変更

2026年9月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定試薬の変更に伴い検査内容を変更させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

ご利用の先生方には何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 対象項目および変更日

【変更日】2027年4月1日(木)受付分より

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	検査案内掲載頁
0523	尿素窒素 (UN)	検査方法	ウレアーゼ・GLDH・UV法 (消去)	ウレアーゼ・LED・UV法 (回避)	P3
		報告範囲 (mg/dL)	0. 4未満、 0. 4～99999999. 9	0. 6未満、 0. 6～99999999. 9	
0723	尿素窒素 (UN)[尿]	検査方法	ウレアーゼ・GLDH・UV法 (消去)	ウレアーゼ・LED・UV法 (回避)	
		報告範囲 (mg/dL)	0. 4未満、 0. 4～99999999. 9	0. 6未満、 0. 6～99999999. 9	
	尿素窒素 (UN)[蓄尿]	検査方法	ウレアーゼ・GLDH・UV法 (消去)	ウレアーゼ・LED・UV法 (回避)	


以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL:075-631-6230



■ 現法との比較

● 血清

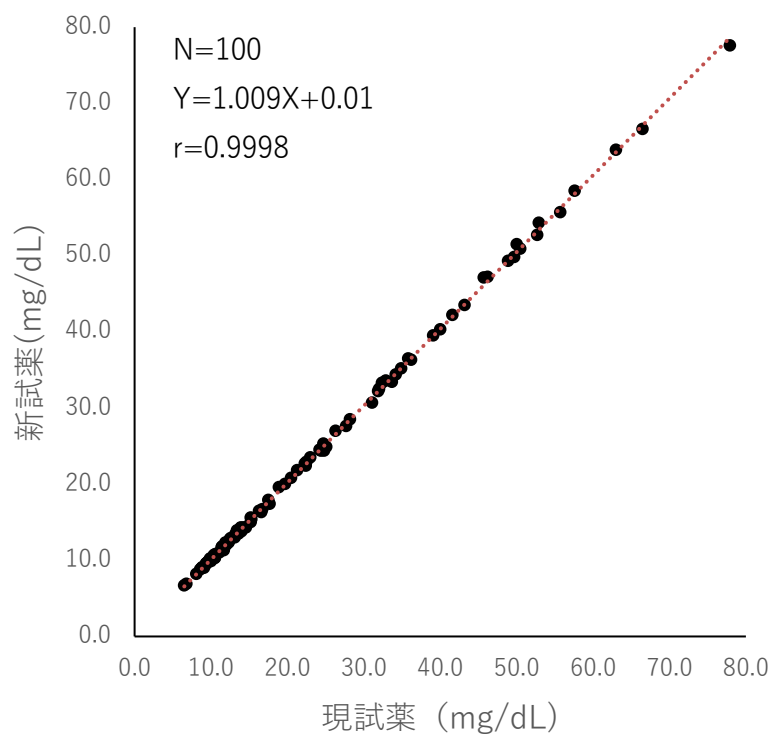

● 尿

